

LAUDO DE MATERIAL

LINDOLFO COLLOR, 28/02/2020

MATERIAL :FITA CREPE HOSPITALAR

69

FABRICADO : CIEX DO BRASIL LTDA

O PRODUTO APRESENTA BAIXA QUALIDADE NO ADESIVO, ADESIVO NÃO ADERE A MATERIA.
PAPEL CREPADO ROMPE-SE COM FACILIDADE

CUSTO BENEFICIO NÃO APROPRIADO, E NÃO OBEDECE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA
EMBALAGEM.

Secretaria Municipal de Saúde
R. Capim, 1221 - Lacerda
Lindolfo Collor / RS

Melen Cristina Ramos dos Santos
COREN-RS-358-207-856

LAUDO DE MATERIAL

LINDOLFO COLLOR, 28/02/2020

MATERIAL :ALGODÃO NATHALYA 8

FABRICADO : EURO MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

O PRODUTO APRESENTA QUALIDADE INFERIOR COM GRUMOS DIMINUINDO ABSORÇÃO.

CUSTO- BENEFICIO NÃO APROPRIADO


Melen Ramos dos Santos
COREN-RS-358-207-EMF

Secretaria Municipal de Saúde
Av. Capoteiro, 1221 - Centro
Lindolfo Collor / RS

LAUDO DE MATERIAL

LINDOLFO COLLOR, 28/02/2020

MATERIAL : EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP DESCARPACK 50

FABRICADO : JIANGSU JICHUN MEDICAL DEVICES Co.LTD

IMPORTADO: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL Ltda

O PRODUTO APRESENTA-SE COM FALHAS NA CONEXÃO COM EQUIPO OU COM DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, FAZENDO COM QUE O CUSTO BENEFICIO SEJA NÃO APROPRIADO.


Kelen Cristina Ramos dos Santos

Associação de Defesa do Consumidor
R. Capelinha, 1221 - Curitiba
Lindolfo Collor / RS

LAUDO DE MATERIAL

LINDOLFO COLLOR, 28/02/2020

MATERIAL : EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS MEDSONDA CORTA FLUXO 50

FABRICADO : MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES DESC. LTDA.

TRATA-SE DE UM POLIFIX 2 VIAS (FIGURA 1 E FIGURA 2). O PRODUTO APRESENTA FALHAS NA CONEXÃO COM O DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, NÃO ENCAIXA DE FORMA SEGURA, POSSIBILITANDO FÁCIL DESENCAIXE AO MOVIMENTAR O MEMBRO PUNÇIONADO. O DISPOSITIVO DE CLAMPEAMENTO NAS DUAS VIAS DISTAIS NÃO É EFETIVO, PERMITINDO REFLUXO SANGUÍNEO COM FACILIDADE MESMO APÓS SALINIZAÇÃO DO ACESSO VENOSO; AS DUAS TAMPAS DISTAIS SÃO FRÁGEIS E TAMBÉM PERMITEM O REFLUXO SANGUÍNEO. O PRODUTO É MUITO RÍGIDO, O QUE DIFICULTA O MANUSEIO PARA A FIXAÇÃO SEGURA DO ACESSO VENOSO. DESSA FORMA, NÃO RECOMENDO ESTE MATERIAL PARA USO NO SERVIÇO DE SAÚDE.

FIGURA 1


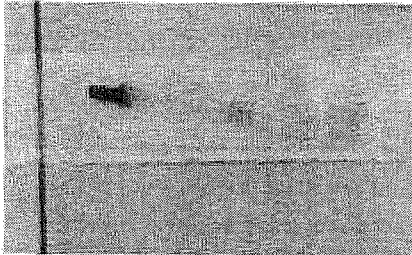


FIGURA 2

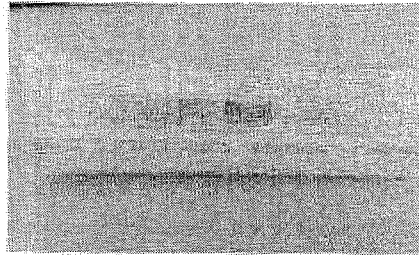

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Copacabana, 1201 - Centro
Lindolfo Collor / RS

Kelen Cristina Ramos dos Santos
Kelen Cristina Ramos dos Santos
COREN-RS-850-207-ENF

LAUDO DE MATERIAL

LINDOLFO COLLOR, 28/02/2020

MATERIAL : ATADURA DE EUROPA

17-22

FABRICADO : POLAR FIX INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES Ltda

PRODUTO APRESENTA TRAMAS FROUXAS COM FREQUENCIA.

CUSTO BENEFICIO NÃO APROPRIADO


Helen Cristina Ramos dos Santos
COREN-RS-350-207-ENF

Secretaria Municipal de Saúde
Av. Engenheiro, 1221 - Cascaes
Lindolfo Collor / RS

LAUDO DE MATERIAL

LINDOLFO COLLOR, 28/02/2020

MATERIAL : ATADURA DE CREPOM PEROLA ANDREONI E CREPOM MB

FABRICADO : MB TEXTIL LTDA

17.22

O PRODUTO APRESENTA TRAMAS DA MALHA MUITO FROUXAS E SEPARADAS. A EMBALAGEM AFIRMA POSSUIR 1,80M EM REPOUSO MAS SÓ POSSUI 1,20M EM TODAS AS APRESENTAÇÕES LARGURA 5 6CM , 8CM , 10CM , 12CM , 15CM , 20CM.

CUSTO BENEFICIO NÃO APROPRIADO, E NÃO OBEDECE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA EMBALAGEM.


Aileen Cristina Ramos dos Santos
COBEN-RS-350-207-ENT

Secretaria de Planejamento da Saúde
Av. Copacabana, 1223 - Copacabana
Lindolfo Collor / RJ

LAUDO DE MATERIAL

LINDOLFO COLLOR, 28/02/2020

29

MATERIAL :Compressa cirúrgicas (Campo Operatório)45x50cm radiopaco ERIMAX

FABRICADO :ERIMAX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

O PRODUTO APRESENTA TRAMAS DA MALHA MUITO FROUXAS E SEPARADAS (QUALIDADE RUIM COM CONSEQUENTE REDUZIDA VIDA ÚTIL).

CUSTO- BENEFICIO NÃO APROPRIADO .


Kelen Cristina Ramos dos Santos
COREN-RS-330.207-ENT

Secretaria Municipal de Saúde
R. Capistrano, 1221 - Centro
Lindolfo Collor / RS

LAUDO DE MATERIAL

LINDOLFO COLLOR, 28/02/2020

MATERIAL : COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 cm

FABRICADO : MDA INDUSTRIA E COMERCIO

O PRODUTO APRESENTA TRAMAS DA MALHA MUITO FROUXAS E SEPARADAS , COM DIMENSOES DE 5,5 X 5,5 cm, MAS A EMBALAGEM AFIRMA QUE TEM 7,5X 7,5cm, CUSTO BENEFICIO SEJA NÃO APROPRIADO, E NÃO OBEDECE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA EMBALAGEM.


Kelen Cristina Ramos dos Santos
COREN-RS-350-207-EXT

Secretaria de Saúde de Lindolfo Collor
Av. Copelamar, 1221 - Centro
Lindolfo Collor / RS

LAUDO DE MATERIAL

LINDOLFO COLLOR, 28/02/2020

30-35

MATERIAL : Cateter venoso marca HEALCATH CALIBRES 16G, 18G, 20G, 22G-24G

FABRICADO : NA INDIA

IMPORTAFO POR GAMMA CRUCIS :

TRATA-SE DE UM CATETER VENOSO; O PRODUTO APRESENTA FALHAS NA CONEXÃO COM O EQUIPO, NÃO ENCAIXA DE FORMA SEGURA, POSSIBILITANDO FÁCIL DESENCAIXE AO MOVIMENTAR O MEMBRO PUNCIONADO. A AGULHA (MANDRIL) APRESENTA-SE COM POUCO FIO DIFICULTANDO A PENETRAÇÃO NA PELE .O MATERIAL QUE PERMANECE NO VASO ROMPE-SE COM FACILIDADE . O QUE DIFICULTA O MANUSEIO PARA DO ACESSO VENOSO. O ROTULO NÃO IDENTIFICA COM FACILIDADE O FABRICANTE E INDORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO DESSA FORMA, NÃO RECOMENDO ESTE MATERIAL PARA USO NO SERVIÇO DE SAÚDE.


Kelen Cristina Ramos dos Santos
COREN-RS-350.207-EST

Secretaria Municipal de Saúde
Av. Capão da Canoa, 1223 - Capão da Canoa
Estrada Collor / 143